


ND3AH

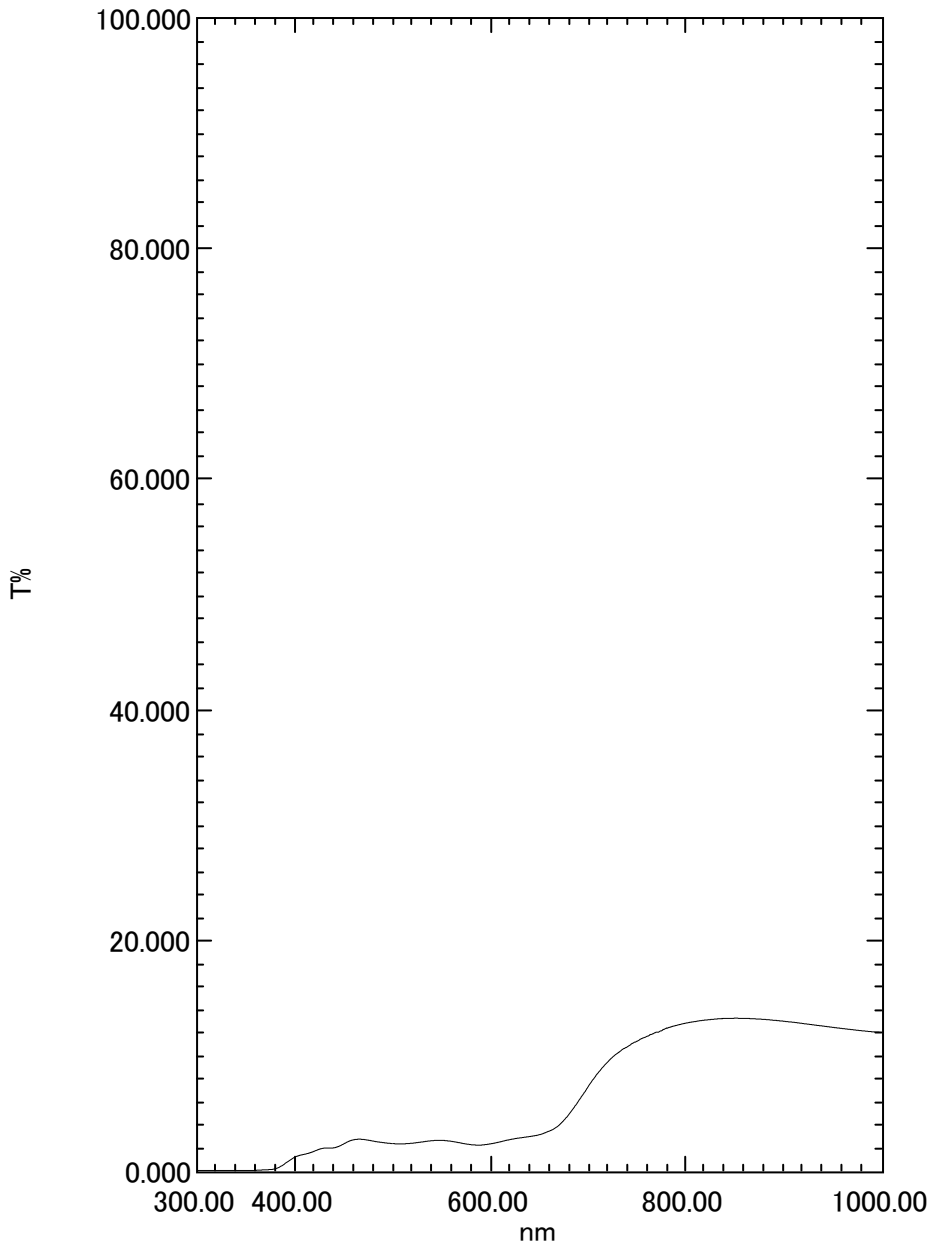

[測定プロパティ]

波長範囲(nm): 300.00 ~ 1000.00
 スキャン スピード: 中速
 サンプルングピッチ: 0.5
 オート サンプルングピッチ: 有効
 測定モード: オート

[装置プロパティ]

装置の種類: UV-3600Plus シリーズ
 測光値: 透過率
 スリット幅: (20)
 時定数: 0.1 秒
 光源: 自動
 光源切替波長: 282.00 nm

.....

波長 (nm)	RawData ...
300.00	0.000
310.00	0.001
320.00	0.000
330.00	0.000
340.00	0.000
350.00	0.001
360.00	0.012
370.00	0.060
380.00	0.149
390.00	0.598
400.00	1.150
410.00	1.411
420.00	1.676
430.00	1.939
440.00	1.969
450.00	2.307
460.00	2.658
470.00	2.693
480.00	2.552
490.00	2.421
500.00	2.333
510.00	2.308
520.00	2.365
530.00	2.472
540.00	2.582
550.00	2.611
560.00	2.531
570.00	2.379
580.00	2.240
590.00	2.204
600.00	2.307
610.00	2.484
620.00	2.678
630.00	2.825
640.00	2.941
650.00	3.100
660.00	3.412
670.00	3.914
680.00	4.829
690.00	6.005
700.00	7.277
710.00	8.447
720.00	9.410
730.00	10.165
740.00	10.733
750.00	11.214
760.00	11.637
770.00	12.003
780.00	12.348
790.00	12.577
800.00	12.791
810.00	12.927
820.00	13.048
830.00	13.138
840.00	13.185
850.00	13.210
860.00	13.199
870.00	13.160
880.00	13.108
890.00	13.033
900.00	12.950
910.00	12.857
920.00	12.747
930.00	12.638
940.00	12.532
950.00	12.423
960.00	12.318
970.00	12.218
980.00	12.124
990.00	12.041
1000.00	11.974